MICROCRE 研润光机


# GQH-T98A 双组份微量红外线气体分析仪

产品资料摘要

型号 GQH-T98A 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

红外分析仪采用负滤光分析技术，选用半导体红外检测器，光学干涉滤光片、集成电路制成的在线自动分析仪。

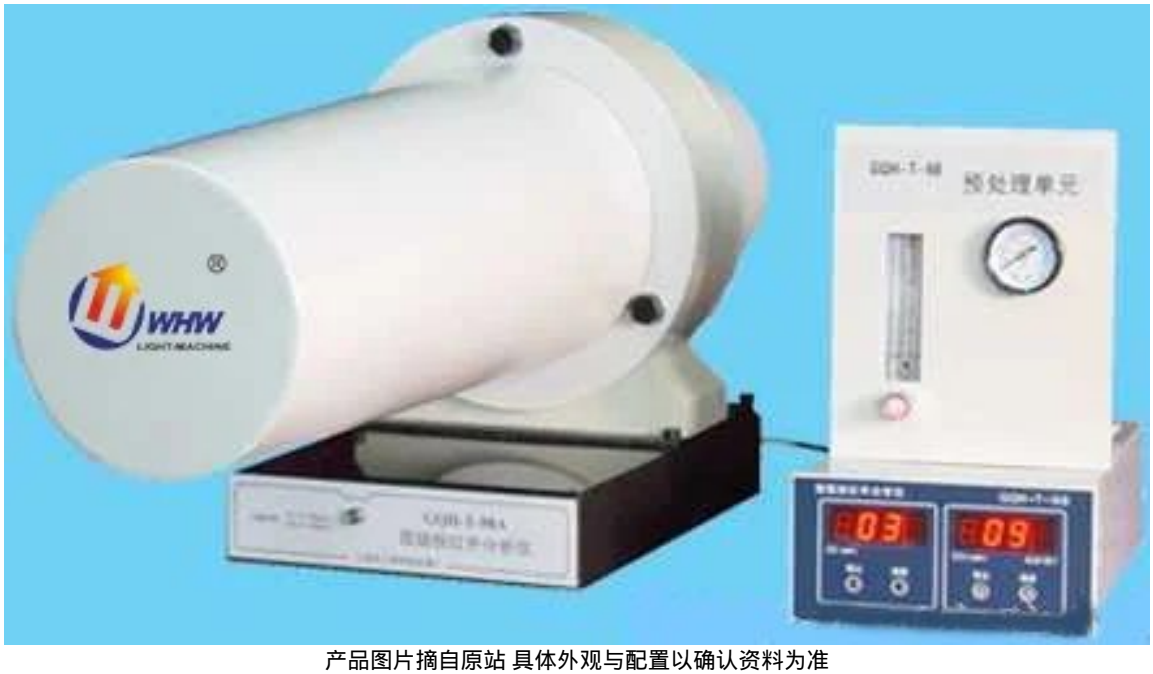


产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

## 技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 测量组份 | 能同时进行CO、CO2两个组份的自动分析。 |
| 测量量程 | 0--100ppm（CO） 0--100ppm（CO2） |
| 被测气温度 | 5～40℃ |
| 被测气压力 | 3Kg |
| 被测气流量 | ≥500ml/min |
| 响应时间 | ≤90秒 |
| 重复性 | ≤±1.5%& |

| 参数项目 | 原站列示数值或说明 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 5 ~ 40℃ |
| 外型尺寸 | 780×340×400 |
| 精度 | 2级 |
| 重量 | 7.5Kg |

## 资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/GQH-T98A.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。