MICROCRE 研润光机


WZS-1000 浊度计

产品资料摘要

型号 WZS-1000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

WZS-1000浊度计是根据国家标准，利用光的散射原理，设计开发的具有微机处理功能的新型高精度浊度计。

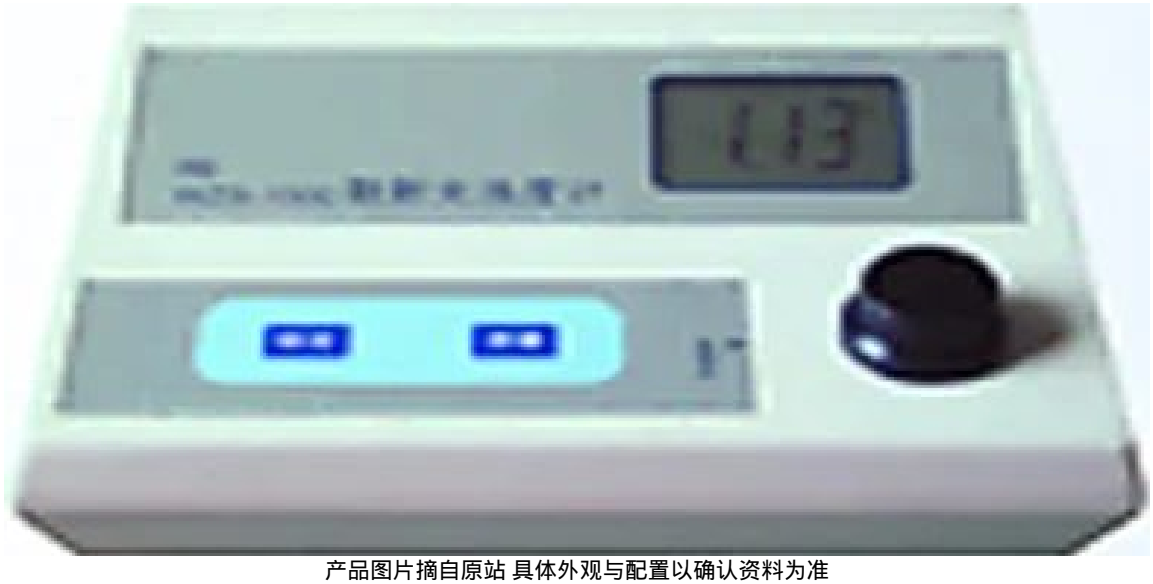

产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
测量范围	0-20NTU，0-200NTU，0-1000NTU三档自动换档
示值误差	±2%以内
重复性误差	±1.5%
示值精度	0.01NTU
零点漂移	±0.1NTU

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/WZS-1000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。